

HZY-K 开口闪点测试仪

产
品
说
明
书



武汉赫兹电力设备有限公司

尊敬的顾客：

感谢您购买本公司 HZY-K 开口闪点测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

——安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

一、前言

感谢您选用本公司的产品，为此本公司将为您提供全面的技术支持和服务保障。本产品需由具备使用资格的人士使用，在使用本产品之前，请您仔细阅读产品使用说明书，并理解所述内容，了解设备自身的技术参数、性能及操作使用方法，严格遵守电气高压试验相关标准和电业安全操作规程进行操作。请将本使用说明书置于容易获取的位置，以便于以后参考使用。

使用本产品还需遵守当地关于该类设备的相关使用要求（如有），以及相关的试验要求、标准、规程等，并在遵守当地关于电力作业安全相关要求的前提下使用本产品。

二、功能特点

全自动闪点测定仪，以触摸屏代替键盘操作。用于测定石油产品的开口闪点值。采用国外的先进技术，液晶大屏幕 LCD 全中文显示人机对话界面，全屏触摸按键提示输入，方便快捷，开放式、模糊控制集成软件，模块化结构，符合国标、美国、欧盟等标准。是理想的进口仪器替代产品。广泛应用于铁路，航空，电力，石油行业及科研部门等。

1. 采用新型高速数字信号处理器，工作可靠精度高；
2. 一台主机可同时控制多台测试炉进行多个样品测试，节省测试时间；
3. 检测、开盖、点火、报警、冷却、打印，整个实验过程自动完成；
4. 铂金电热丝或气点火方式；
5. 大气压强自动检测，自动修正测试结果；
6. 采用新研制的大功率高频开关电源加热技术，加热效率高，采用自适应 PID 控制算法，自动调节升温曲线；
7. 温度超值自动停止检测并报警；
8. 热敏式微型打印机，使得打印更美观更快捷，具有脱机打印功能；
9. 带时间标记的历史纪录，最多存储255个；
10. 带温度补偿的百年历时钟，走时准确，自动记录测定的日期和时间，在掉电的状态下可运行10年以上；
11. 采用320x240大屏幕图形LCD显示屏，汉字显示界面，内容丰富；
12. 采用全屏触摸屏按键，操作直观方便；
13. 内置多个执行标准可供选择。

三、工作原理：

该仪器在国家标准规定的条件下，把试样装入试验杯，对装有试验油的试验杯加热，产生的石油蒸气与周围空气形成的混合气体在与火焰接触发生闪火时的最低温度作为闪点。

数字信号处理器根据所采集的温度变化情况，控制加热器，使试油温度按一定速率上升；点火时间、闪火检测、实现自动控制；当闪火被测出时，系统停止数据采集，显示闪火温度并打印记录结果，停止加热。

四、技术性能：

1、温度测量：

测温范围：-59.9℃-399.9℃

控温范围：室温-399.9℃

重复性： ≤150℃ 3℃
 >150℃ 5℃

分辨率： 0.1℃

精 度： 0.5%

测温传感器：铂电阻 (PT100)

闪火传感器：离子检测环

2、环境温度： 10—40℃

相对湿度： < 85%

供电电压： AC220V±10%

功率： < 500W

3、升温速度： 符合国标、美国、欧盟等标准

4、外形尺寸：

440X280X290 (mm)

5、仪器重量： 14kg

五、仪器结构及安装：



1、仪器安装：

- ①、打开仪器包装，检查该仪器有无破损；
- ②、按装箱单核对仪器型号及配件；
- ③、检查仪器无误后方可进行仪器的调试。

2、仪器开机准备：

- ①、将测试炉电源线插入 AC220V 三芯插座；
注意：务必使用带可靠接地的电源插座为仪器供电；
- ②、试验油杯用石油醚清洗干净，倒入试样至刻度线，放入加热器内；
- ③、正确安装铂合金电热丝点火头。

六、使用方法及操作步骤：

3、试验步骤：

- ①、打开电源开关，屏幕显示欢迎画面见图 6-1；



图 6-1 开机界面图

按“设置”键，进入参数设置功能画面，如图 6-2

按“记录”键，进入历史记录功能画面；如图 6-3

按“测定”键，进入样品测定功能画面；如图 6-4

②、参数设置功能画面：



图 6-2 参数设置

用手指触摸（或用触摸笔触摸）要修改的项目；用“▲”、“▼”键，调整选中的数字；调整完毕后按下“保存”键，将当前的调整数值写入仪器；按“退出”键返回画面 6-1。

更改炉号：特别注意：保证在只挂接一个炉子的情况下更改！方法如下：用手指触摸炉号后面的数字，用“▲”、“▼”键，调整选中的数字；修改完后，按“保存”键即可，炉号下面有设置成功与否的信息提示。

③、历史记录功能画面：



图 6-3 历史记录

按“前页”、“后页”键顺序查看记录；按“打印”键将该记录通过仪器的微型打印机打印出来；按“删除”键从仪器历史记录中删除该条记录；按“退出”键返回画面 6-1。


④、样品测定功能画面：

2010-08-11		12:23:45	
	1号炉	2号炉 开	3号炉
执行标准		3536-2008	
当前温度		23.6	
预闪值		200	
闪点值			
燃点值			
运行状态	未联机	等待测试	未联机
大气压：1018.5 kPa			
开始		停止	退出

图 6-4 样品测定

◆用手指触摸（或用触摸笔触摸）“1号炉”、“2号炉”、“3号炉”对应的一列来选择要操作的炉号。

◆用手指触摸（或用触摸笔触摸）炉号下面的“执行标准”、“预闪值”对应的参数，选中后用“▲”、“▼”键，调整选中的数字或文字；当选择“执行标准”参数后，按“▲”、“▼”键选择执行标准，当执行标准为“自定义”时，这时按两次“自定义”进入自定义参数设置画面，如图 6-5

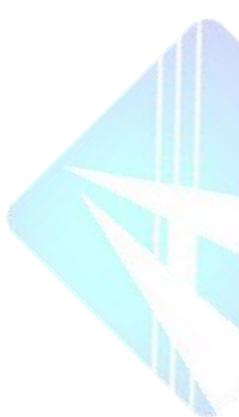

2010-08-11		12:23:45	
2号炉	【开】	执行标准：自定义	
预闪值之前：000 度开始后段升温控制			
前段升温速：00.0		后段升温速：00.0	
预闪值之前：000 度第一次点火			
有效值下限：预闪值 - 00			
预闪值上限：预闪值 + 00			
温度每升高：0 度重复点火			
点火方式：电			
▲	▼	保存	退出

图 6-5 自定义参数设置

这时，用手指触摸选中要修改的项目，用“▲”、“▼”键，调整选中的数字；调整完毕后按下“保存”键，将当前的调整数值写入仪器；按“退出”键返回画面 6-4。

开口闪点测定时，还可以选择是否进行“燃点测试”。

◆按“开始”键对应测试炉启动测试。按“停止”键，对应测试炉退出测试状态，并启动冷却风扇。

◆按“▲”键对应测试炉抬高炉臂；按“停止”键，对应测试炉停止上升炉臂，并停止冷却风扇。

◆按“▼”键对应测试炉降低炉臂。按“停止”键，对应测试炉停止降低炉臂，并停止冷却风扇。

预闪值设定应遵循如下方法：当闪点值为 200℃时，设置预闪值应低于闪点值 10℃为 190℃，不知油样闪点温度时设置值应设置闪点温度临界值，再由低温到高温设置。

◆按“退出”键仪器退出测试状态，所有的测试炉停止任何动作返回到画面 1。

◆仪器自动测试当前的大气压强值，根据选择的执行标准，自动计算闪点修正值，显示于测试画面。

◆炉子的开、闭口类型由挂接的炉子决定。

⑤、测试结果显示画面：

仪器在按照选择的执行标准所要求的测试过程，并做大气压修正，记录测试结果，并启动冷却风扇。测试结果如图 6-6 所示。

2010-08-11		12:23:45	
	1号炉	2号炉[开]	3号炉
执行标准		3536-2008	
当前温度		23.6	
预闪值		200	
闪点值		215.2	
燃点值			
运行状态	未联机	测试完成	未联机
大气压：	101.5 kPa		
开始		停止	退出

图 6-6 测试结果显示

仪器在测试过程中，检测各种故障并提示用户，用户可根据故障提示内容采取对应的解决方案。

冷却风扇有两种启动方法：

1、进入测试状态后，按“停止”键退出测试状态，同时启动冷却风扇；

2、测试过程结束或其他原因仪器由测试过程进入停止测试状态，启动冷却风扇；

停止冷却风扇有三种方法：

- 1、按“退出”键退出测试画面，同时停止冷却风扇；
- 2、按“▲”键后，按“停止”键，停止上升的同时停止冷却风扇；
- 3、按“▼”键后，按“停止”键，停止下降的同时停止冷却风扇；

七、注意事项及仪器维护

- 1、仪器应在无腐蚀环境中使用。
- 2、更换试样时，油杯须进行清洗。
- 3、检测热电偶不应有油污，以免影响检测灵敏度。
- 4、测试过程中，不要接触点火头、油杯及周围高温部分，以免烫伤。
- 5、采用电点火方式的仪器，电点火丝需定期更换。点火丝每亮 1000 次（约合 80-100 次试验），需更换点火丝。

八、故障及处理方法

	现象	原因	处理
1	打开电源，液晶屏幕无显示	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源未插好 ● 各插头有松动。 	插好电源 插好有松动的插头
2	试样重复性误差较大	<ul style="list-style-type: none"> ● 搅拌轴断 ● 热电偶有油影响灵敏度 	更换搅拌轴 用滤纸沾干热电偶上的油迹
3	不加热	<ul style="list-style-type: none"> ● 电热丝断 	更换电热丝
4	升降臂不升或不降	<ul style="list-style-type: none"> ● 电机与升降臂螺丝脱落 ● 限位光耦损坏 	拧紧螺丝 更换限位光耦

售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

二、产品的质保：

自整机收到货后提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

四、服务管理制度及体系：

- 1、**售前服务：** 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务：** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、**售后服务：** 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
- 4、**售后服务申明：** 本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。